

NEGATIVOSCOPI
OTTOTIPI

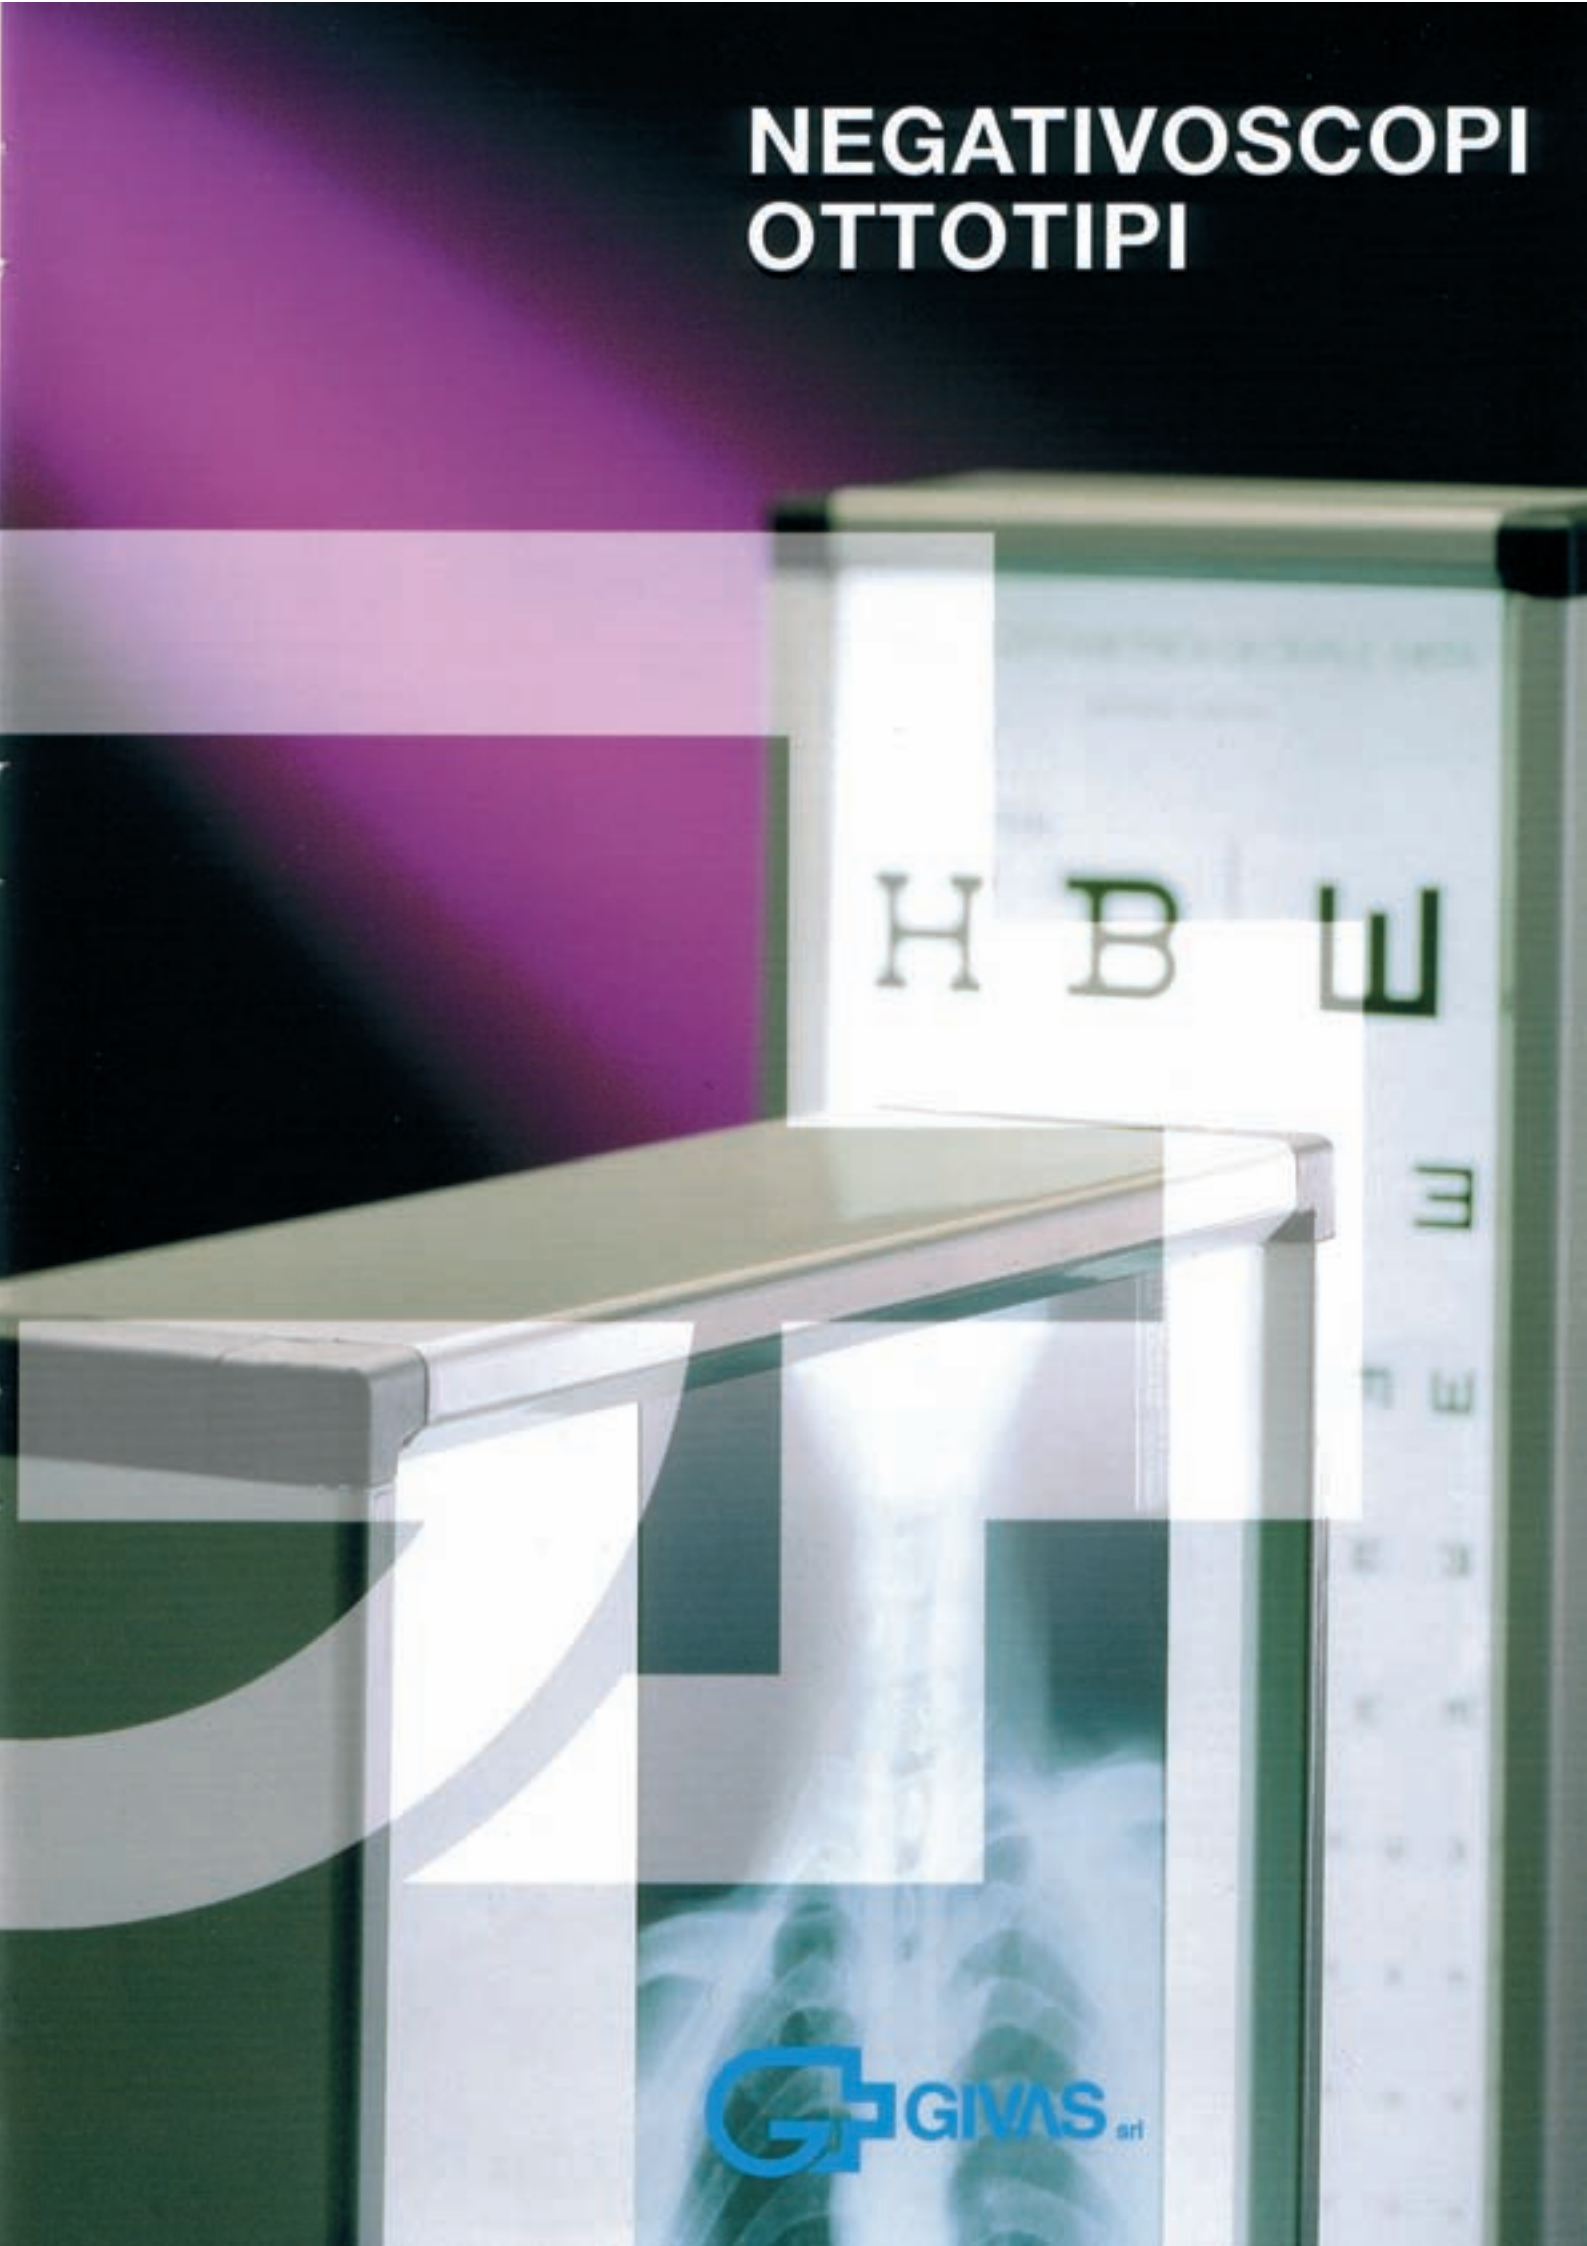

Negativoscopi

Viwers

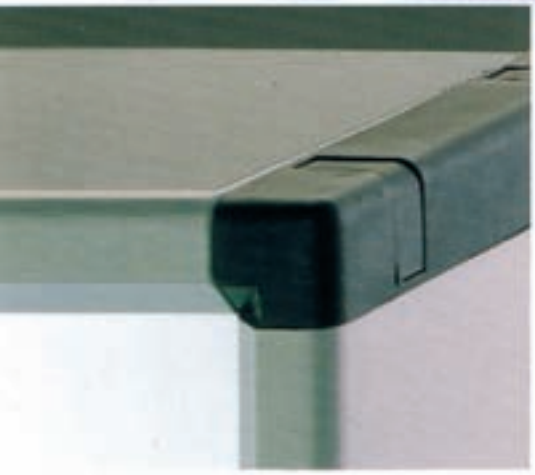

Abbiamo creato questa nuova collezione di negativoscopi, ottotipi e carrelli dedicata ai nostri clienti più esigenti, i quali sanno che i nostri metodi di progettazione e realizzazione sono tra i più tecnologicamente innovativi e rispondenti a tutte le esigenze degli operatori sanitari.

La struttura dei nostri articoli è realizzata in profilo estruso di alluminio trattato con polveri epossidiche a forno e con sistema blocca lastra incorporato.
I vari componenti sono uniti tra loro per mezzo di giunti angolari stampati in nylon. Impianto luminoso a luce fredda. Lastra acrilica opalina bianca. Impianto elettrico composto da: presa, interruttore acceso/spento e fusibili di sicurezza.
Tutti i negativoscopi e ottotipi sono conformi alle norme C.E.I.

We have created this new range of wievers, optotypes and trolleys for our most exating customers who know that methods of planning and production are amongst the most technologically innovative and answer to all the needs of the health operators.

The design of our instruments has been realized in oven-fired epoxy powered aluminium sections incorporating X-ray negative clips.
The various sections are held together with hardnearing nylon corner joints. Lamp fitting give off cold light. Acrylic opalescent white plates.
Electrical circuits consisting of a plug on/off switch and fuse.
All viewers and optotypes follow E.E.C. regulations

CR6000

Carrello porta lastre
Struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri termoindurenti. Parte superiore con vano scorrevole porta cartelle per lastre. Maniglia per spinta. Coperchio in laminato plastico. Parte inferiore con vano a giorno passante. 4 ruote alla base di cui 2 con freno.
Completo di n. 50 porta lastre.
Dim. cm. 90×52×96 h.


Portable X-ray negative file
A steel laminated structure varnished with heat-toughened thermosetting composition powders. The upper part consists of a space for sliding X-ray negative trolley handle. Plastic laminated lid. Lower part has been space-mounted on four wheels of which two with brakes. Complete with 50 X-ray negative folders.
Dim. cm. 90×52×96 h.




CR6002

Carrello porta lastre con negativoscopio
Struttura come il precedente.
Dotato inoltre di un negativoscopio da cm. 90×13×52 h. con impianto elettrico. Alimentazione 220 Volt. Interruttore acceso/spento. Fusibili di sicurezza. Spirale per collegamento rete elettrica.
Completo di n. 50 porta lastre.
Dim. cm. 90×52×107 h.

Portable X-ray negative file and viewer
As above but also incorporating a viewer cm. 90×13×52 h. with electrical circuit. 220 V. supply. On/off switch. Fuse. Coiled supply head.
Complete with 50 X-ray negative folders.
Dim. cm. 90×52×107 h.

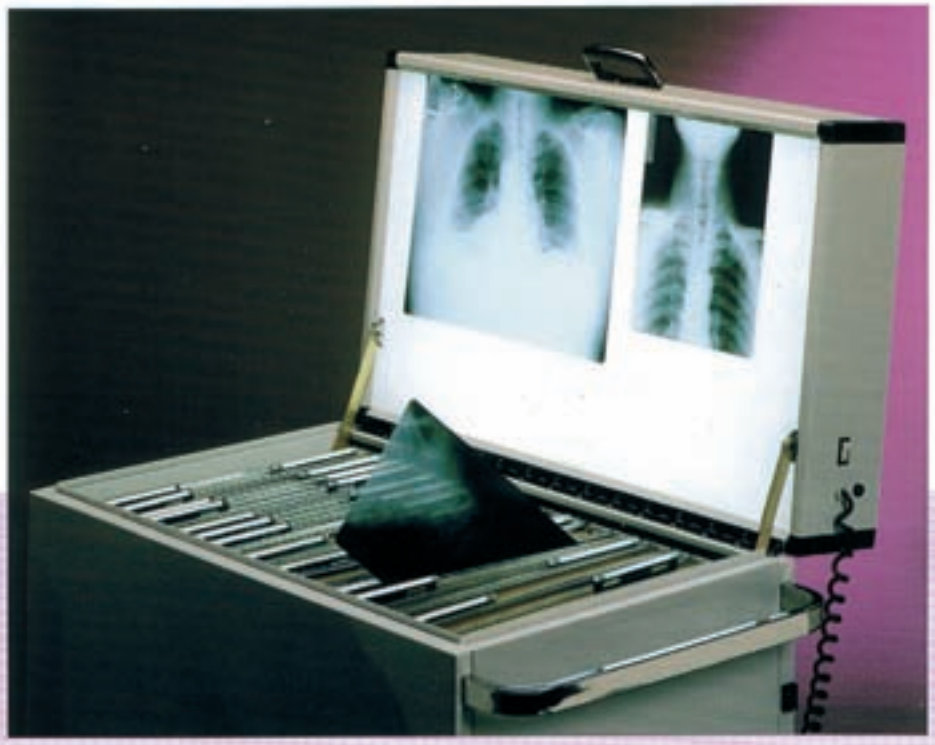

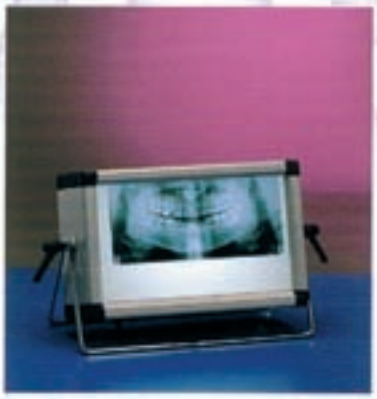

AN6004

Negativoscopio da tavolo
Cm. 38×13×23 h. con supporto.
Table top viewer
Cm. 38×13×23 h. with support.




AN6006

Negativoscopio da parete
Cm. 50×13×48 h.
Wall viewer
Cm. 50×13×48 h.




AN6008

Negativoscopio orizzontale da parete
Cm. 90×13×52 h.
Horizontal wall viewer
Cm. 90×13×23 h.

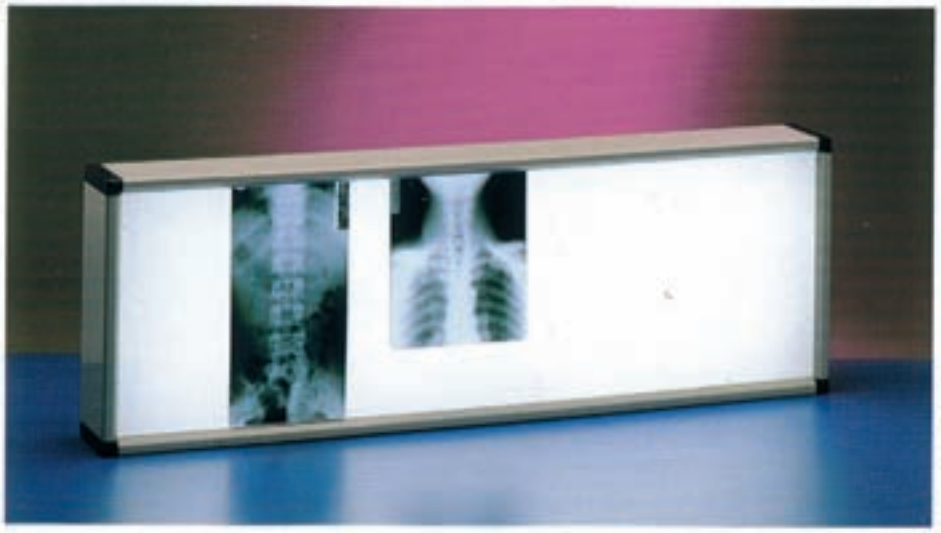

AN6010

Negativoscopio orizzontale da parete
Cm. 127×13×48 h.
Horizontal wall viewer
Cm. 127×13×48 h.

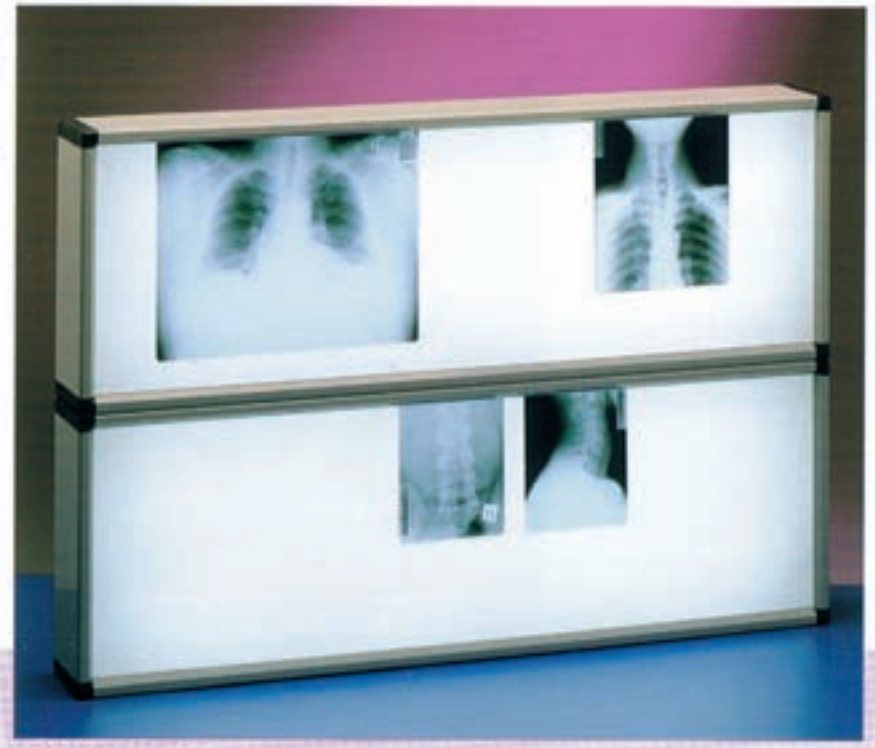

AN6012

Negativoscopio orizzontale doppio
Cm. 127×13×96 h.
Double horizontal viewer
Cm. 127×13×96 h.



AN6014

Negativoscopio verticale da parete
Cm. 65×13×95 h.
Vertical wall viewer
Cm. 65×13×95 h.



AN6016

Ottotipo luminoso da mt. 3 tipo Monoyer
Cm. 29×13×67 h.

Illuminated optotype 3 mt. Monoyer
Cm. 29×13×67 h.



AN6018

Ottotipo luminoso da mt. 5 tipo Monoyer
Cm. 29×13×67 h.

Illuminated optotype 5 mt. Monoyer
Cm. 29×13×67 h.



AN6020

Ottotipo luminoso da mt. 3 misto
Cm. 29×13×67 h.

Illuminated optotype 3 mt. mixed
Cm. 29×13×67 h.



AN6022

Ottotipo luminoso da mt. 3 bambini
Cm. 29×13×67 h.

Illuminated optotype 3 mt. children
Cm. 29×13×67 h.

AN6030

Tavola ottometrica
In cartone da mt. 3 tipo Monoyer.

Optometric chart
Cardboard 3 mt. Monoyer.

AN6032

Tavola ottometrica
In cartone da mt. 5 tipo Monoyer.

Optometric chart
Cardboard 5 mt. Monoyer.

AN6034


Tavola ottometrica
In cartone da mt. 3 mista.

Optometric chart
Cardboard 3 mt. mixed.

AN6036

Tavola ottometrica
In cartone da mt. 3 per bambini.

Optometric chart
Cardboard 3 mt. for children.

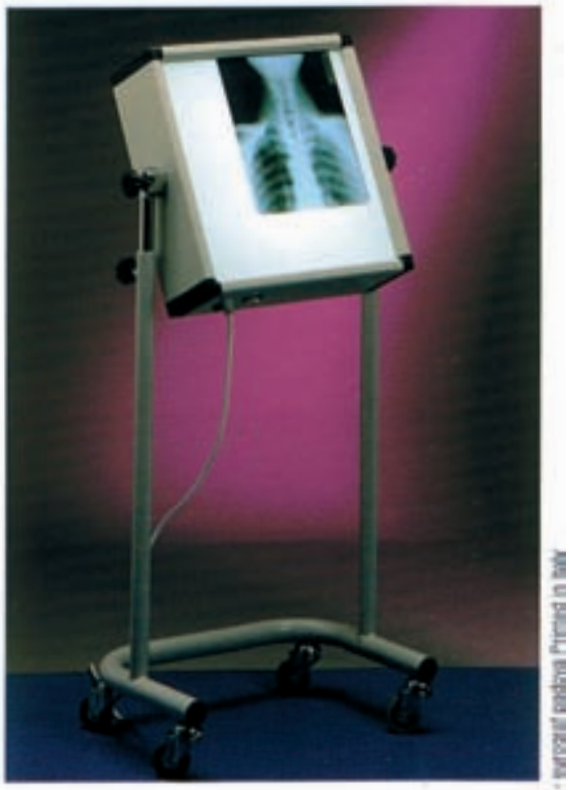

AN6028

Negativoscopio su carrello
Completo di negativoscopio, con caratteristiche analoghe ai precedenti, da cm. 50×13×48 h. Carrello in acciaio verniciato e parti cromate. 4 ruote ∅ 80. Possibilità di regolazione in altezza, da cm. 98 a cm. 144, inclinabile.
Dim. 64×50×98/144 h.

Portable viewer
Cm. 50×13×48 h. Varnished steel frame and chrome parts. 4 wheels ∅ 80. Possibility of regulating height from 98 cm. to 144 cm., inclinable.
Dim. 64×50×98/144 h.

Quality Certification Bureau Inc.
ISO 9001:2000 Registered QMS

Accredited by the Dutch Council for Accreditation

Areha

GIVAS srl
35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
http://www.givas.it
info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals and Communities

Cat. 007 - Ed. 11/2004 - offset - impianti padova Printed in Italy

L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the righ of partial reproduction.